


Zusammenfassung Ihres Berichtes zum Ringversuch

Code	Analyt	Einheit	Zielwert	Ihr Resultat	FAC Auswertung	QUALAB Auswertung
46	U-Albumin, mikro-	mg/L	55	54	Ausgezeichnet	Konform
49	U-Chlorid	mmol/L	168	162	Ausgezeichnet	keine Vorgabe
50	U-Natrium	mmol/L	166	169	Ausgezeichnet	keine Vorgabe
51	U-Kalium	mmol/L	76.8	78	Ausgezeichnet	keine Vorgabe
52	U-Calcium, gesamt	mmol/L	3.0	2.9	Ausgezeichnet	keine Vorgabe
55	U-Protein, gesamt	mg/L	590	641	Sehr gut	Konform
58	U-Urate (Harnsäure)	mmol/L	0.8	0.80325	Ausgezeichnet	keine Vorgabe
60	U-Amylase, gesamt	U/L	195	195	Ausgezeichnet	keine Vorgabe


U-Albumin, mikro- [46]

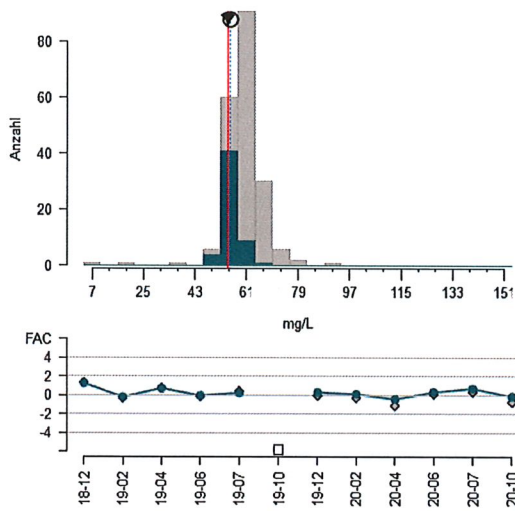

Ihre Resultate :

Gerät :	Cobas 8000 c 701	
Resultat :	54 mg/L	
QUALAB Auswertung :	Konform	
QUALAB Bereich :	[41-69] (24%)	
FAC-Wert :	-0.13 (Ausgezeichnet) ●	-0.74 ◇
Z-Score :	-0.4	-1.09
Methode	TurbKolor [780]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	55	199
Zielwert :	55 mg/L	60 mg/L
Unsicherheit :	< 1 mg/L	
SD :	2.52 mg/L	5.11 mg/L
VK :	4.58 %	8.59 %

U-Chlorid [49]

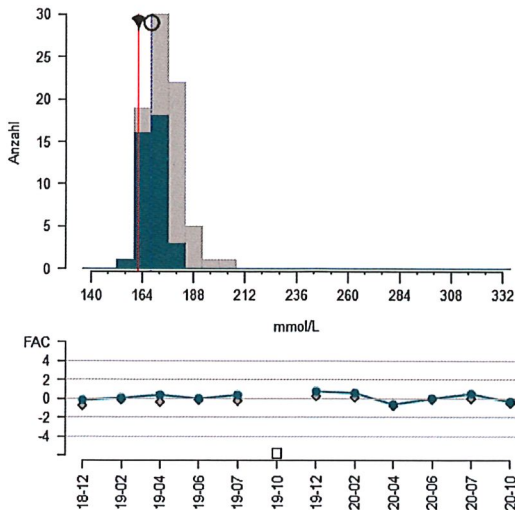

Ihre Resultate :

Gerät :	Cobas 8000 c 701	
Resultat :	162 mmol/L	
QUALAB Auswertung :	keine Vorgabe	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	-0.33 (Ausgezeichnet) ●	-0.5 ◇
Z-Score :	-1.52	-1.06
Methode	Chlorid(2) [721]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	38	79
Zielwert :	168 mmol/L	171 mmol/L
Unsicherheit :	< 1 mmol/L	
SD :	3.95 mmol/L	8.52 mmol/L
VK :	2.35 %	4.99 %